ИНСТРУКЦИЯ по применению аппарата ТГСп-3 (2 в 1)
(Тольяттинский Генератор Сигнала портативный - 3 серии)

1. ВВЕДЕНИЕ

Статистика применения аппаратов серии ТГСп (антипаразит) и ТГС показала, что наибольшую эффективность воздействия на организм, происходит при совместном, одновременном применении двух технологий:

- Контактный метод (электроды с ТГСп2);
- Полевое воздействие («катушка Мишина» с генератором синуса)

Поэтому был разработан и изготовлен аппарат 2 в 1, модель «ТГСп-3 (2 в 1)», который совмещает в себе обе данные технологии.

Аппарат ТГСп-3 имеет два выхода для подключения:

«Выход-1» (АНТИПАРАЗИТ) – источник специализированного сигнала по методу Хильды Кларк.

«Выход-2» (для «катушки Мишина») – генератор синуса, для подключения «катушек Мишина».

При включении аппарата «Выход-1» и «Выход-2» работают одновременно, это позволяет пользоваться ими как совместно, так и по отдельности.

Аппараты серии ТГСп (антипаразит) и ТГС оказывают оздоровительное воздействие и не являются медицинскими изделиями (по смыслу статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Оздоровительное воздействие аппаратов не подменяет традиционные способы и схемы лечения. Для достижения эффекта рекомендуется консультация специалиста.

2. УСТРОЙСТВО АППАРАТА

Аппарат состоит из пластикового корпуса, собранного из двух половин. В нижней половине размещена литий-ионная аккумуляторная батарея (Li-ion 18650). В верхней половине электронная печатная плата, разъем питания и два разъёма подключения электродов и катушек. Лицевая панель с кнопками и ручкой управления, 2 экрана символьной индикации. В комплект входят два электрода, с серым проводом (+), с чёрным (-), катушка «Тор», катушка «Диск».

3.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТОМ

1. Разъем для подключения зарядного устройства 5В, USB-C.

2. Батарея (Светодиоды). Индикация уровня заряда аккумулятора.

3. Таймер. Индикатор времени работы.

4. ВКЛ. Кнопка управления электропитанием аппарата.

5. Параметры. Индикатор параметров сигнала.

6. Ручка настройки параметров сигнала. (Регулировка яркости дисплея, отключение звука)

7. Ген_А. Режим биорезонансного воздействия.

8. Ген_В. Режим генерации высокочастотной волны по методу Хильды Кларк.

9. Ручн. Кнопка перевода аппарата в ручной режим.

10. 15мин. Таймер длительности работы аппарата.

11. 30мин. Таймер длительности работы аппарата.

12. 60мин.Таймер длительности работы аппарата.

13. Контакт. Индикатор правильного использования электродов режим антипаразит «Выход-1».

14. «Выход-1» «Антипаразит», подключения контактов (электродов).

15. «Выход-2» «Синус», подключения катушек

16. Резонанс. Индикатор режима резонанса катушки. Генератор синуса «Выход-2».

17. Переключатель выбора мощности аппарата Антипаразит 50% (0) и 100% (**I**).

Схема аппарата собрана на печатной плате и отличается высокой надежностью. Электроды имеют полярность.

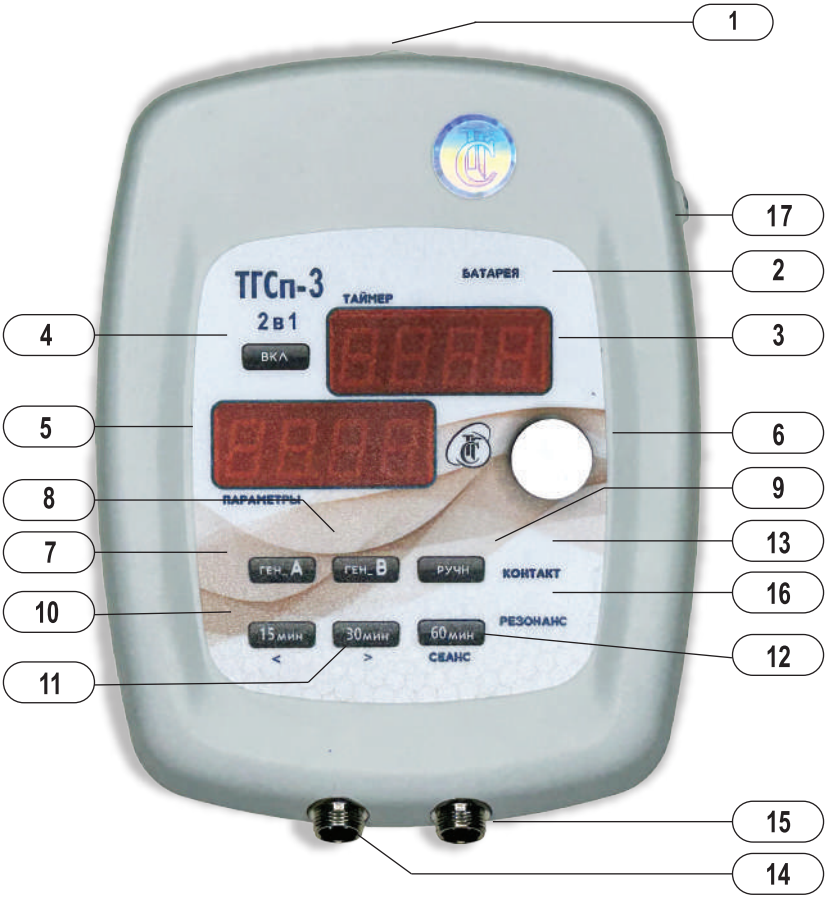
1
17
2
4
3
5
6
8
9
7
13
10
16
12
11
15
14
ТГСп-3
2в1
ВКЛ
ТАЙМЕР
БАТАРЕЯ
ПАРАМЕТРЫ
ГЕН_А
ГЕН_В
РУЧН
КОНТАКТ
РЕЗОНАНС
15мин
30мин
60мин
СЕАНС

4. РАЗДЕЛ №1 РЕЖИМ АНТИПАРАЗИТ (Выход-1)

4.1 Принцип действия режима АНТИПАРАЗИТ

Работа аппарата основана на открытии врачей-натуропатов из США, давших аппарату название **«Цеппер»**. В 1989 г., в ходе исследований, было обнаружено, что все виды живых организмов выделяют слабое излучение электромагнитного спектра частот. Выяснилось, что паразиты, обитающие в теле человека и животных, а также бактерии, грибки и вирусы излучают поле только на одной, характерной для каждого вида частоте. Был составлен каталог частот для большинства известных науке видов патогенных бактерий, вирусов и паразитов. Во время продолжающихся экспериментов с воздействием слабого электрического тока на инфекционных возбудителей болезней в 1993 г. было обнаружено, что воздействие на заражённый организм слабым импульсным током частотой в диапазоне от 30кГц и более приводит к исчезновению в нём патогенных бактерий, вирусов и паразитов – пропадают соответствующие резонансы. При этом угнетения полезных видов бактерий не обнаружено. Симбионты находятся в биологической связи с организмом человека и при уменьшении их числа или активности организм восстанавливает необходимый баланс. Аппарат «ТГСп-3 (2 в 1)» генерирует ток положительной полярности в режиме «Ген_А» и импульсный ток положительной полярности в режиме «Ген_В». Обеспечивая подавляющее воздействие на все патологические виды (паразитов, бактерий, вирусов, грибков) как сообщества, резонирующие в указанном диапазоне частот.

- Режим **«Ген_А»** основан на инерционном воздействии на микроорганизмы, аналогичный биорезонансному воздействию с диапазоном частот 30-999кГц.

- Для достижения наибольшей эффективности воздействия прибора, следует применять оба режима. Режим **«Ген_В»** основан на двухчастотном использовании динамической скважности в диапазоне 30-100кГц.

- Заданная на генераторе частота вызывает в организме гармонический ряд резонансных частот, охватывающих весь диапазон частот, губительных для заболеваний.

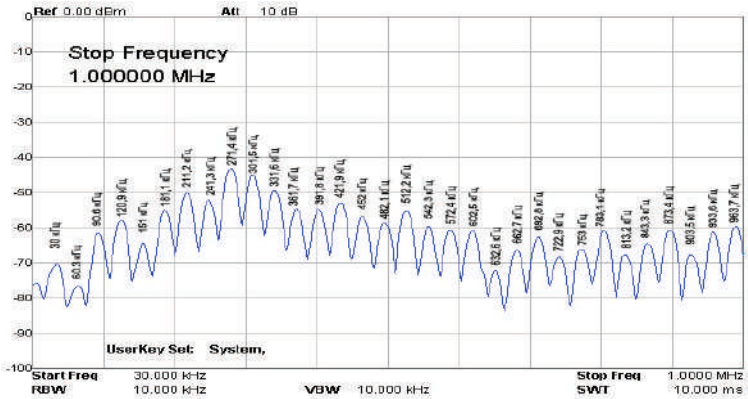

Помимо борьбы с паразитами аппарат «ТГСп-3 (2 в 1)» стимулирует нервные окончания и лимфатическую систему. Универсальность аппарата заключается в том, что им можно оздоравливать организм одновременно двумя способами, контактным и бесконтактным, что в разы усиливает прохождение электрических полей, а следовательно, и усиливает оздоровительный эффект.

4.2 Режим «EASY» - автоматический «Выход - 1».

Для работы аппарата необходимо отключить зарядное устройство и подключить контактные электроды к **«Выход - 1»**. Нажать кнопку **«Вкл»**. При включении на верхнем индикаторе загорится **«EASY»**, на нижнем версия прошивки. Далее аппарат включится в основном режиме генерации **«Ген_А»** и начнется последовательный перебор частот от 30 кГц до 999 кГц с шагом 0,2 кГц. Текущее значения частоты будет отражаться на табло «параметры». Необходимо взять электроды в руки (или по схеме в инструкции) на панели аппарата должен загореться индикатор контакт (13). По умолчанию аппарат запускает таймер на **«15 мин»**. Параметры таймера задаются нажатием, до загорания соответствующего светодиода, на одну из кнопок **«15 мин», «30 мин», «60 мин»**.

При необходимости можно установить и перебирать частоту сигнала вручную. Для этого следует нажать и удерживать, до загорания соответствующего светодиода, кнопку **«РУЧН»** (сопровождается включением светодиода над соответствующей кнопкой), затем вращать ручку настройки. На табло **«параметры»** отразится изменение частоты с шагом в 1 кГц. Если нажать, с удерживанием до звукового сигнала, сверху на ручку настройки, то шаг изменения частоты уменьшится до 0,1 кГц. Повторное нажатие на ручку настройки приведет к увеличению шага изменения частоты до 1 кГц. Изменение параметров аппарата с активированным **«Ген_В»** производятся аналогично **«Ген_А»** (см. описание выше).

● **Дополнительные функции для удобства пользователя:**

- Регулировка яркости индикации дисплея.

Осуществляется вращением ручки (6), имеет 4 уровня яркости, с возможностью полного отключения индикации в крайнем положении регулятора.

- Функция плавной регулировки мощности сигнала (доступна через 3 секунды после включения), осуществляется нажатием ручки (6) до появления одинарного звукового сигнала. На дисплее, вместо времени таймера, появится **9U** - значение максимальной мощности сигнала, по умолчанию. Вращением ручки (6) можно изменять мощность выходного сигнала от максимального значения **9U** до минимального значения **2U**. Повторное нажатие на ручку (6) сохранит установки мощности и вернёт на дисплей индикацию времени таймера.

- Функция плавной регулировки мощности выходного сигнала применяется в случае дискомфорта и болезненных ощущений, при контактном методе использования прибора. Зависит от индивидуальных параметров проводимости и сопротивления кожи. Рекомендуем снижать мощность выходного сигнала при возникновении дискомфорта во время процедур, во избежание покраснений кожи в месте контакта электродов с телом.

- Отключение системных звуков **(MUTE).** Вкл/Откл функции осуществляется длительным нажатием и удержанием ручки (6) (до двух звуковых сигналов), функция сохраняется после отключения аппарата.

● Работа аппарата в режиме «PLUS» с программой «Ген_А» (биорезонансное воздействие).

Нажать и удерживать кнопку (9) **(Ручн)**, потом нажать кнопку (4) **(ВКЛ)**, на верхнем экране появится надпись **(PLUS)**, это означает, что режим включился (кнопки (9) и (4) нужно отпустить). Нажав кнопку (9) **(Ручн)** на нижнем экране, появится значение **30F** (начальная частота), для подстройки частоты под конкретного паразита, вращая ручкой (6) выбрать необходимую частоту от **30F** (кГц), до **999F** (кГц). Допустим **100F** (стартовая частота выбрана), нажмите кнопку (10) **(15 мин)** на нижнем экране появится значение **(15А)**, (это заданное значение времени (цеппинг*) 15 минут). Вращая ручку (6), можно изменить время сеанса от 3 мин до 60 мин. Снова нажатием кнопки (10) **(15 мин)** на нижнем экране (5) появится надпись **(5п)**, регулятором (6) выбираем необходимое число повторений в каждом шаге от 30 до 60, например **30п**. Для выбора диапазона перебора частот, нажимаем кнопку (10) **(15мин)**, на нижнем экране появится символ **00d**, ручкой (6) выбрать необходимый интервал частот от **00d** до **99d**, например **30d**, отключаем ручной режим нажатием на кнопку (9) **(Ручн).** Запускаем таймер нажатием кнопки (12). Получилось: частота будет перебираться от **100F** (кГц) до **130F** (кГц), 10 минут с повторением **30п**. Аппарат запоминает введёные данные на период проводимого сеанса.

● Работа аппарата в режиме «PLUS» с программой «Ген_Б» (методика Хильды Кларк).

Нажать и удерживать кнопку (9) **(Ручн)**, потом нажать кнопку (4) **(ВКЛ)**, на верхнем экране появится надпись **(PLUS)**, это означает, что режим включился (кнопки (9) и (4) нужно отпустить. Нажав кнопку (9) **(Ручн)** на нижнем экране, появится значение **30F** (кГц), (начальная частота), для подстройки частоты под конкретного паразита вращая ручкой (6), выбрать необходимую частоту, от **30F** (кГц) до **100F** (кГц), допустим **50F** (кГц). Далее нажав на кнопку (10) **(30 мин)** на нижнем экране появится значение **15А**, (это значение времени сеанса 15 минут), вращая ручку (6), можно увеличить время (цеппинга*) от 3 мин до 60 мин, например **10А** таймер будет отсчитывать 10 минут. Нажимаете кнопку (10) **(15 мин)** на нижнем экране появится значение **39q** (это базовое значение скважности), при помощи ручки (6), вращением выбираем скважность от **5q** до **95q**, например **20q**. Для выбора диапазона перебора частот снова нажимаем кнопку (10) **(15мин)**, на нижнем экране появится символ **00d**, ручкой (6) необходимо выбрать нужный интервал частот от **00d** до **99d**, например **20d**. Отключаем ручной режим нажатием кнопки (9) **(Ручн).** Запускаем таймер нажатием кнопки (12). Получилось: Частота будет перебираться от **50F** (кГц) до **70F** (кГц), 10 минут и со скважностью **20q**. Аппарат запоминает введёные данные на период проводимого сеанса, до выключения аппарата.

Рекомендации по применению режима АНТИПАРАЗИТ

Для профилактики рекомендуется пройти двухнедельный курс ежедневного применения аппарата как взрослым, так и детям, а затем проводить сеанс один раз в 1-3 дня. Необходимо понимать, что даже полное подавление на определенное время деятельности возбудителей болезней не гарантирует автоматического оздоровления, потому что при ослабленном иммунитете легко происходит повторное заражение и активизация микробов и паразитов. «Режим АНТИПАРАЗИТ»,

подавляя деятельность возбудителей болезней, предоставляет передышку защитным силам организма, давая им возможность восстановиться и завершить оздоровление. Восстановление иммунитета - достаточно продолжительный органический процесс. Требуется длительное применение аппарата, чтобы вывести иммунитет на качественно новый уровень, хотя в большинстве случаев даже однократное его применение приносит ощутимое улучшение самочувствия на определенное время (от нескольких часов до нескольких суток при хронических заболеваниях).

При этом необходимо продолжать соблюдение всех медицинских рекомендаций, если таковые были.

Примечание

При ОРВИ «Режим АНТИПАРАЗИТ» улучшает самочувствие и ускоряет выздоровление, но не заменяет собой традиционных методов лечения и не отменяет необходимости придерживаться постельного режима.

- При любых хронических заболеваниях «Режим АНТИПАРАЗИТ» является лишь вспомогательным средством повышения иммунитета, но помимо него необходимы традиционные методы лечения.
- При глистных инвазиях применяется «Режим АНТИПАРАЗИТ» согласно рекомендациям по применению.
- Улучшение самочувствия практически всегда наблюдается сразу после сеанса. Применять аппарат рекомендуется вплоть до полного оздоровления.
- При переутомлении, слабости, депрессивных состояниях рекомендуется пройти курс ежедневного сеанса (1 раз в день) в течение 2-4 недель, а затем профилактически проводить однократный сеанс 1-2 раза в неделю.
- При взятии электродов в руки, либо при другом способе прикладывания электродов, загорается индикатор правильного использования электродов **«КОНТАКТ»**. Свечение этого индикатора означает, что аппарат работает, и процесс сеанса действительно происходит. Возможно лёгкое пощипывание со стороны электрода «Плюс», которое представляет собой нормальное явление и не представляет никакой опасности. Оно обусловлено протеканием слабого электрического тока. В то же время отсутствие таких ощущений также является совершенно нормальным. Эффективность работы аппарата не зависит от наличия или отсутствия ощущений пощипывания.
- Существуют различные способы прикладывания электродов к телу, смотри схемы приложения электродов.
- Для исключения раздражения кожи обертывать электрод «Плюс» влажной бумажкой или марлевой салфеткой.
- Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями (особенно аритмией), или ярко выраженной вегето-сосудистой дистонии, не рекомендуется держать электроды в обеих руках одновременно, или прикладывать один из электродов на область сердца. При возникновении неприятных ощущений рекомендуется поменять местоположение электродов.

ВНИМАНИЕ! Во избежание ожогов не прикладывайте электроды к нежным участкам кожи, внутренней стороны сгибов суставов, пах, лицо т. д.

Продолжительность сеанса

Нормальная продолжительность сеанса 15-60 минут. Следует начинать с 15 минут 1-3 раза в день, с каждым днём увеличивая время, доведя его до 60 минут.

Для профилактики 30 - 60 минут, через день. «Режим АНТИПАРАЗИТ» можно использовать одновременно с приёмом медицинских препаратов и проведением назначенных врачом процедур.

Аппарат, при указаных схемах, оказывает тонизирующий эффект на весь организм. Этот эффект был замечен при исследованиях в области электропунктуры. Максимальная эффективность воздействия достигается в случаях совместного, одновременного применения в аппарате «ТГСп-3 (2 в 1)» электродов и катушек.

СХЕМЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ

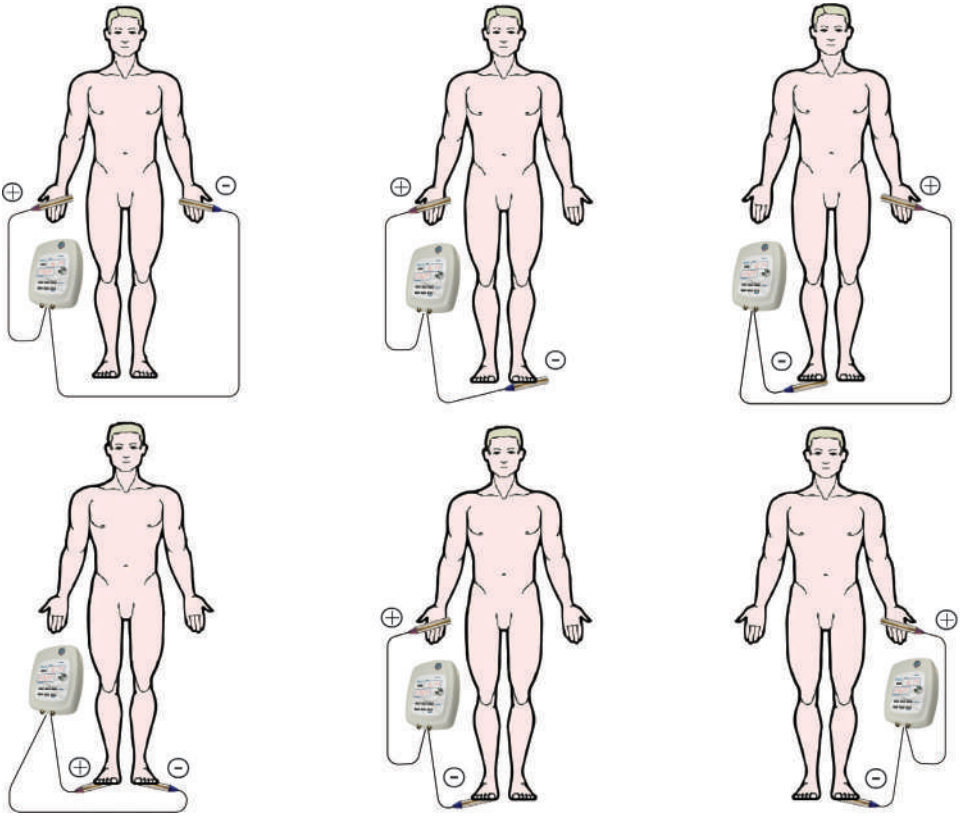

5. РАДЕЛ №2. ГЕНЕРАТОР СИНУСА (Выход-2).

Принцип действия

Аппарат, при помощи катушек, оказывает воздействие переменным электрическим полем высокой частоты (до 400 кГц), но с низким напряжением (до 10 В) и малым выходным током на катушке (силой до 0,3 А). Воздействие оказывается синусоидальным высокочастотным электрическим полем на ткани организма. Высокочастотное электрическое поле (воздействие магнитного поля в приборе минимизируется) влияет на ткани таким образом, что в последних происходит поляризация заряженных частиц и наведение слабых вихревых токов. Как результат этого процесса, происходят сложные физико-химические преобразования в клетках - ткани немного нагреваются, в результате чего возникает успокаивающий эффект на центральную нервную систему **(ЦНС)**.

Вызывает устойчивые оздоровительные эффекты:

- улучшение кровообращения и питания тканей;
- насыщение клеток кислородом;
- отток венозной крови и лимфы;
- активация местного иммунитета;
- снижение чувствительности к боли;
- уменьшение проявлений аллергии, противозудный эффект;
- противовоспалительный и бактерицидный эффект;
- улучшение тонуса и внешнего вида кожи.

Оздоровительный эффект наиболее ощутим при таких состояниях, как:

- заболевания периферической нервной системы;
- невралгии;
- нарушения чувствительности - гипостезии, парестезии;
- остеохондроз позвоночника;
- последствия невритов;
- радикулит;
- расстройства центральной нервной системы;
- неврозы;
- бессонница;
- мигрень;
- нейроциркуляторная дистония;
- энурез;
- нейродермит;

- целлюлит, нарушения периферического кровообращения ;
- варикозное расширение вен;
- заболевания ЛОР-органов;
- воспаления слизистой оболочки рта;
- вазомоторный ринит;
- хронический гайморит;
- заболевания половых органов;
- простатит;
- воспалительные процессы женских половых органов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- доброкачественные и злокачественные новообразования;
- инфекционные заболевания, лихорадочные состояния;
- наличие кардиостимулятора;
- атеросклероз;
- гипертония в 3-й стадии;
- аритмии;
- инфаркт миокарда;
- сердечно-сосудистая недостаточность 2-3 степени;
- острое нарушение мозгового кровообращения - инсульт.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ «Выход-2», генератор синуса.

1. Подключите к разъему (15) любую из катушек, входящих в комплект «Тор» или «Диск». Рабочую поверхность катушки имеют с обеих сторон.

2. В зависимости от процедуры, выставите нужный период времени работы аппарата с помощью кнопок таймера. Светодионые индикаторы укажут на выбранный режим: 15, 30, 60 мин.

3. Проверка правильности работы «Выхода-2» осуществляется при помощи встроенного светодиодного индикатора поля (16) **«РЕЗОНАНС»**, расположенного на рабочей панели.

ВНИМАНИЕ! Если после подключения катушки к «Выходу-2», световой индикатор **«РЕЗОНАНС»** не загорится, значит катушка неисправна.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Аппарат, при помощи катушек, оказывает воздействие переменным электрическим полем высокой частоты (до 400 кГц), но с низким напряжением (до 10 В) и малым выходным током на катушке (силой до 0,3 А). Воздействие оказывается синусоидальным высокочастотным электрическим полем на ткани организма. Высокочастотное электрическое поле (воздействие магнитного поля в приборе минимизируется) влияет на ткани таким образом, что в последних происходит поляризация заряженных частиц и наведение слабых вихревых токов. Как результат этого процесса, происходят сложные физико-химические преобразования в клетках - ткани немного нагреваются, в результате чего возникает успокаивающий эффект на центральную нервную систему (ЦНС).

Воздействие оказывается полем катушки «Диск» или катушки «ТОР» в зависимости от структуры пораженного органа. Катушкой «Диск» - воздействовать на полостные органы (органы брюшной полости, грудной клетки, головы). Катушкой «ТОР» - воздействовать на костно-мышечные образования (суставы, связки, мышцы, рефлексогенные зоны тела).

Длительность воздействия устанавливается на аппарате таймером (15 мин, 30 мин, 60 мин). Звуковой сигнал подаётся при начале и после окончания сеанса (если не активирован бесшумный режим «MUTE»).

В период работы катушки «Диск» или «ТОР» можно перемещать по зоне воздействия совершая остановки, либо производя круговые массирующие движения.

Во время сеанса, при сильно запущенной болезни, организм начнет избавляться от большого количества вредных веществ, что может привести к поднятию температуры и давления. В этом случае сеанс нужно прекратить и возобновить его через 2-3 дня, при мощности аппарата 50%.

Указанные на схемах точки установки катушек не обязательны для обработки за один сеанс. Рассчитывайте, что максимальная продолжительность сеанса 1 час. В следующем сеансе выбираете по схеме другую группу точек, учитывая порядковый номер зоны точек. И продолжайте по этой методике, пока вы не охватите все точки установки катушек, предложенные в схеме для данного заболевания.

Заболевания периферической нервной системы (невралгия, нарушения чувствительности – гипостезии, парестезии, остеохондроз позвоночника, последствия невритов, радикулит

Невриты локтевого, срединного и лучевого нервов
Воздействовать на зоны 1 сочетая с воздействием на зоны 2. Также проводить воздействие на зоны 3.

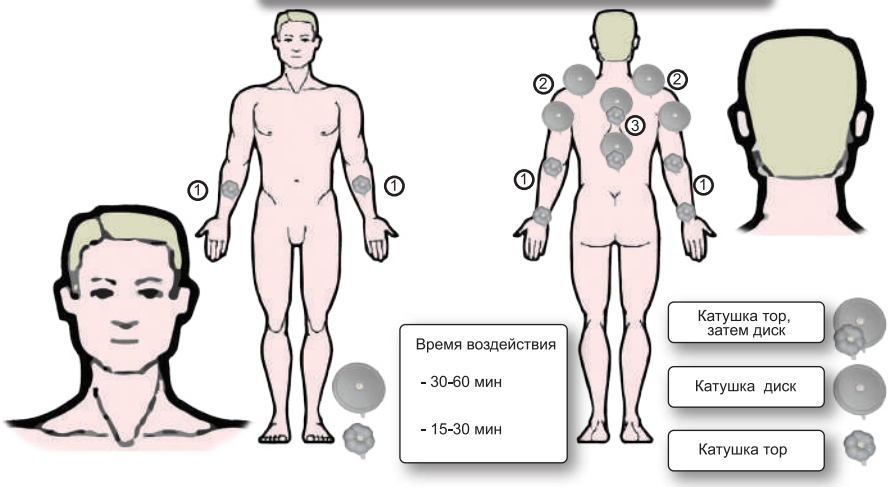

Время воздействия
- 30-60 мин
- 15-30 мин

Катушка тор, затем диск
Катушка диск
Катушка тор

Невриты лицевого нерва
Воздействовать симметрично на зоны.

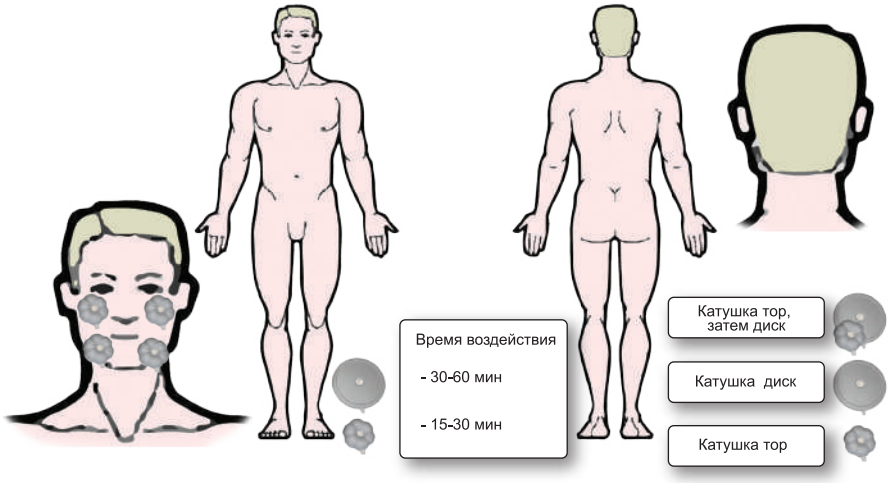

Время воздействия
- 30-60 мин
- 15-30 мин

Катушка тор, затем диск
Катушка диск
Катушка тор

Грудной радикулит
Воздействовать на зоны 1, затем на зоны 2.

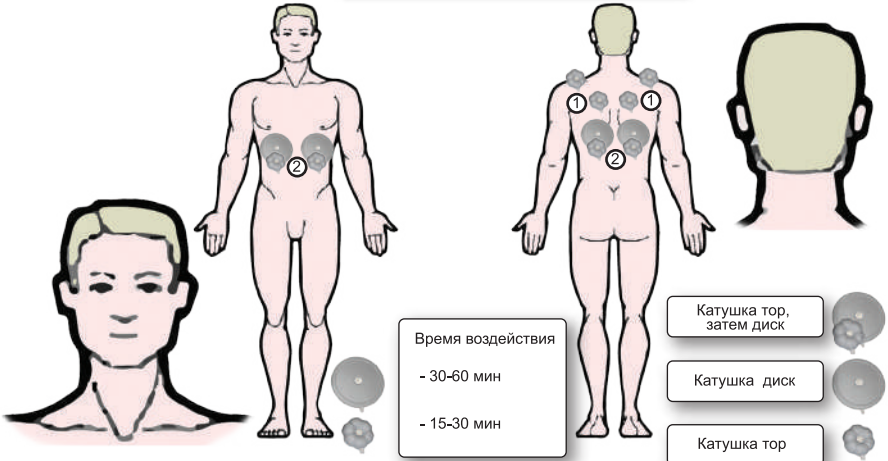

Пояснично-крестцовые расстройства
Воздействовать с двух сторон на зоны 1, расположенные на спине возле позвоночного столба. Затем на основные зоны 2. При распространении болей вниз, в ноги, в живот, проводить воздействие на зоны 3.

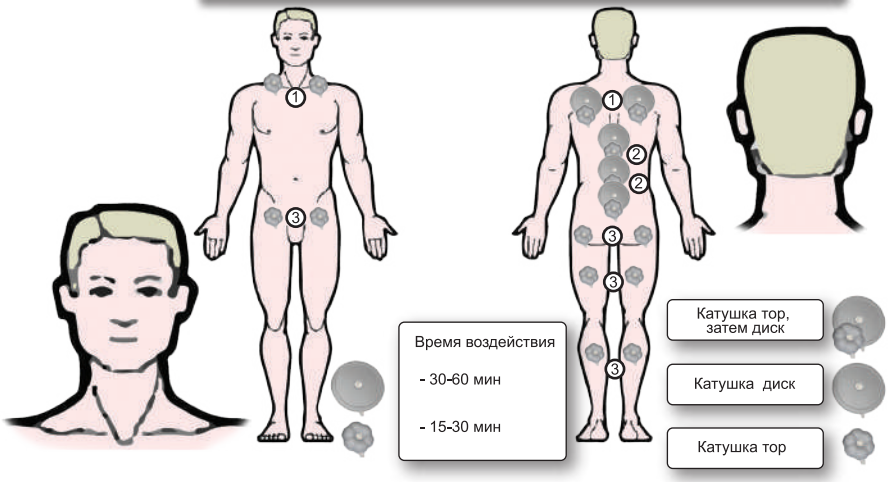

Шейные радикулярные растройства, остехондроз
Воздействовать на зоны 1, далее последовательно на зону распространения болей 2 и зону 3. Тор между ладонями.

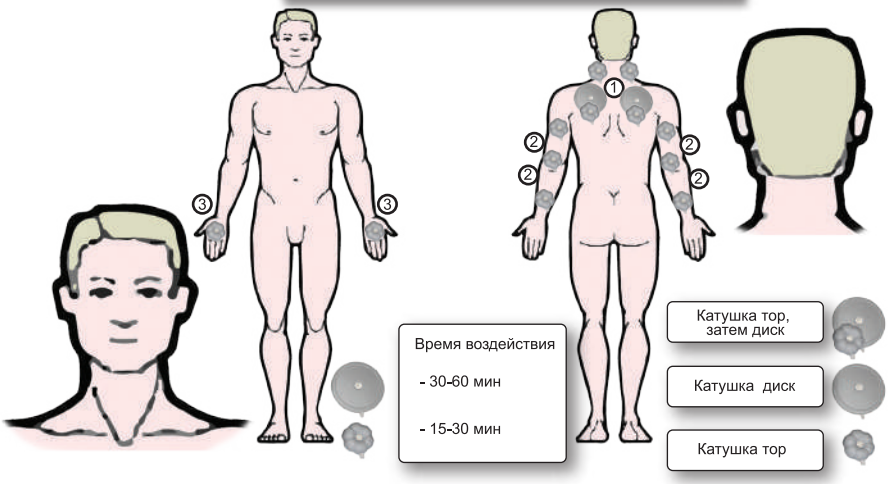

Расстройства центральной нервной системы (неврозы, бессонница, мигрень, нейроциркуляторная дистония, энурез, нейродермит)

Невралгия тройничного нерва
Независимо от локализации болей, воздействовать на зоны выхода лицевого нерва 1, с двух сторон, начиная со здоровой стороны, затем на зону 2.

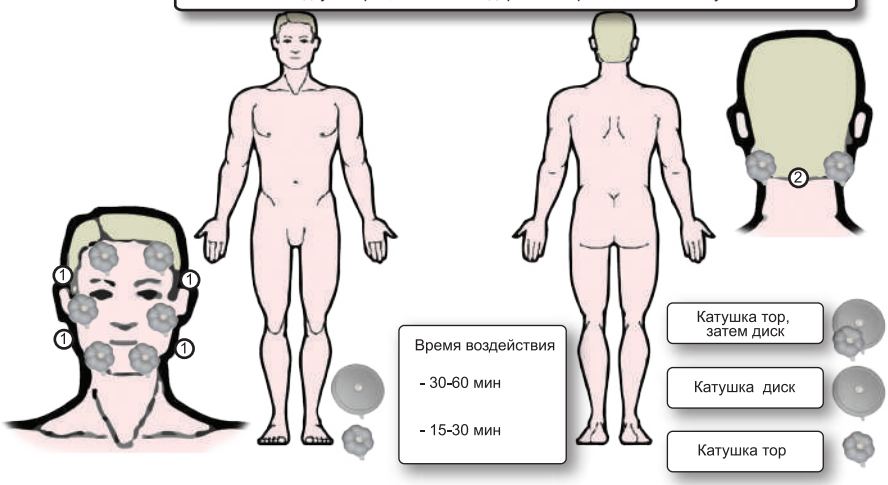

Мигрень (приступ головной боли)
Зона 1 затылок, зона 2 виски, зона 3 основание черепа.

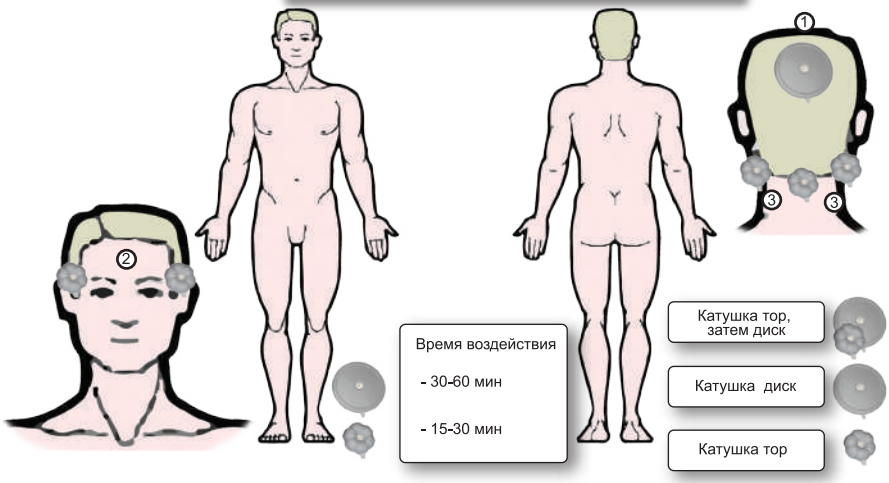

Целлюлит, нарушения периферического кровообращения, варикозное расширение вен

Целлюлит, нарушения периферического кровоснабжения, варикозное расширение вен
Воздействовать на основне зоны 1, затем на зоны 2 и 3.

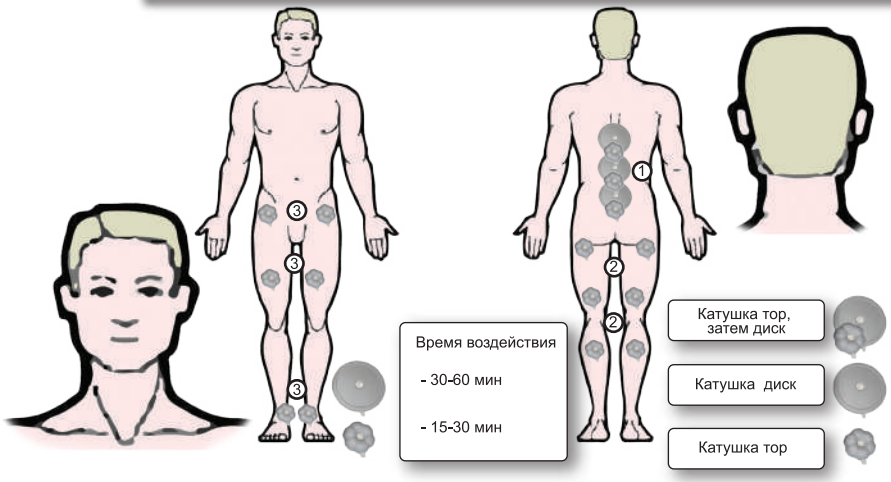

Заболевания ЛОР-органов (воспаления слизистой оболочки рта, вазомоторный ринит, хронический гайморит)

Отит, воспалительный процесс в ухе
Воздействовать на зоны 1 - в области виска, заушную область, затем зоны 2 - область запястья, зоны 3 между большим и указательным пальцем.

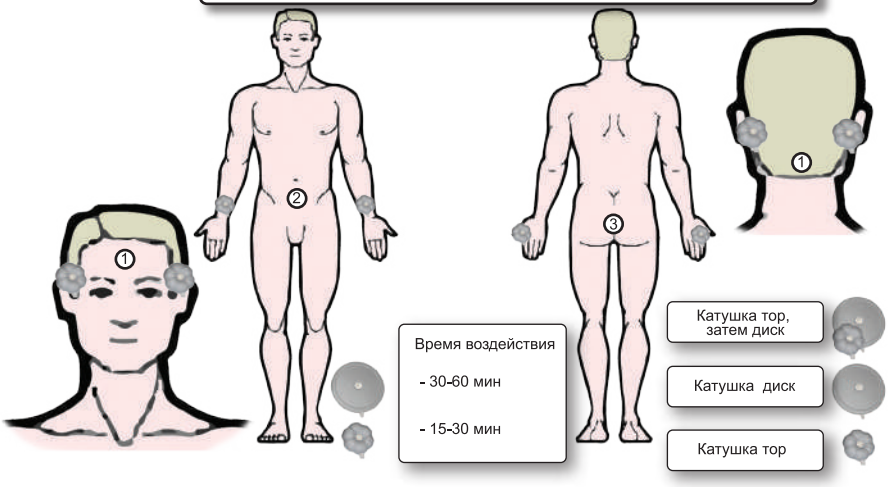

Острый гайморит и обострение хронического гайморита
Воздействовать на зоны 1, затем на зоны 2 - область затылка и шейный позвонок. Зона 3 - катушка тор между ладонями.

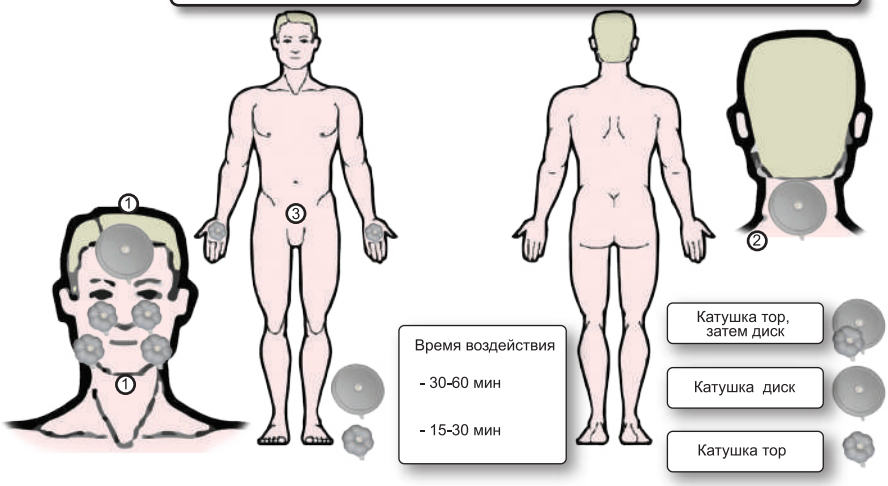

Аллергический ринит (насморк)
Воздействовать на зоны 1, затем зоны 2 и зоны 3.

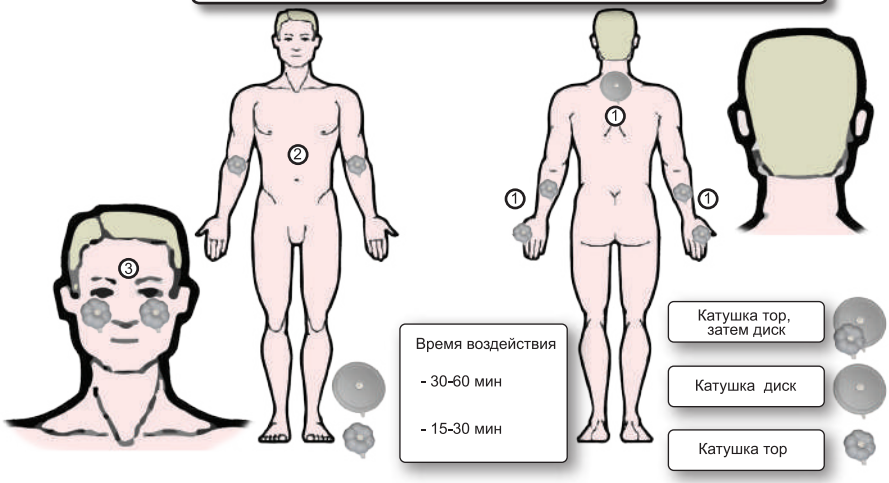

Заболевания половых органов (простатит, воспалительные процессы женских половых органов)

Простатит
Воздействовать на зоны 1, зоны 2 и зоны 3 - область промежности.

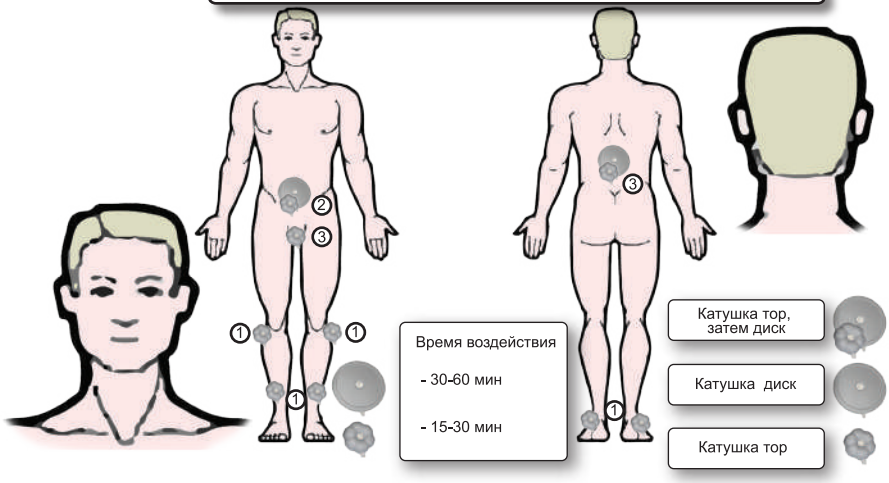

Нарушение менструального цикла
Воздействовать на зоны.

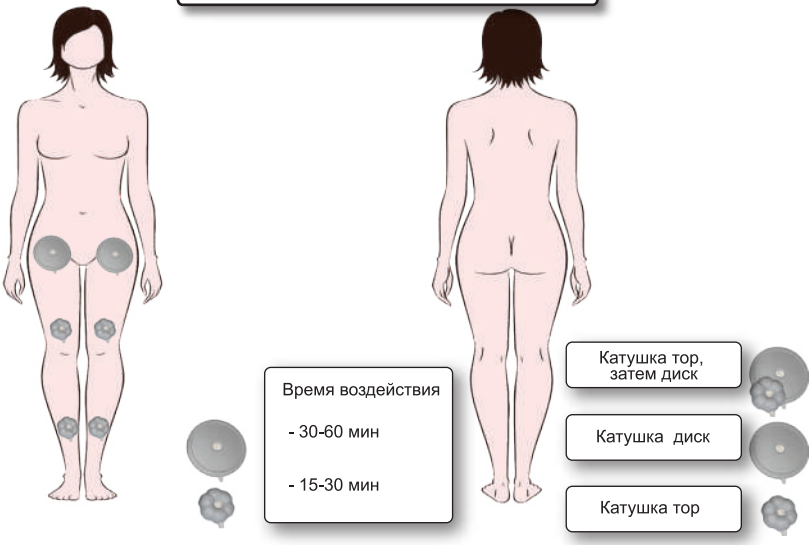

Болезненные менструации
Воздействовать на зоны 1, затем зоны 2

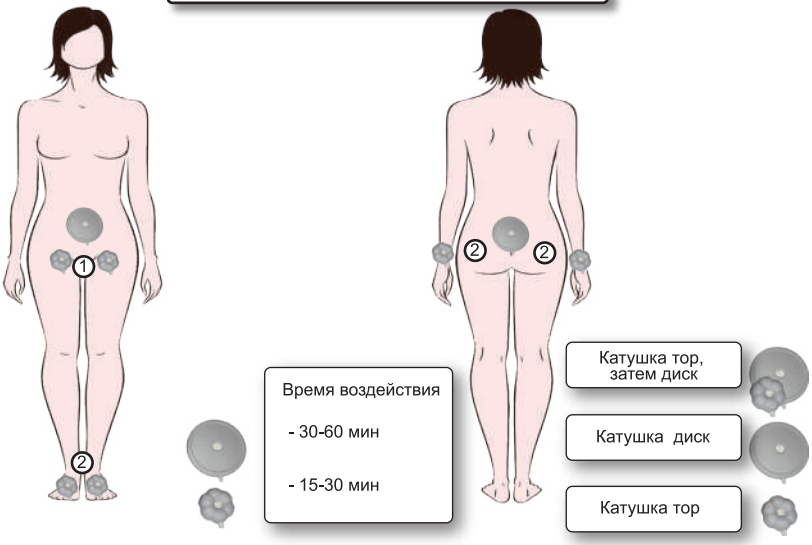

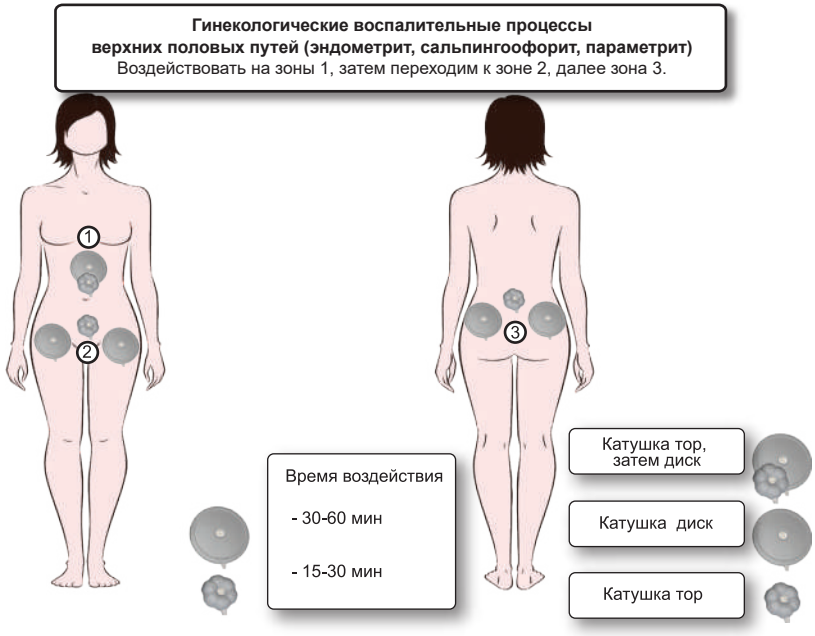

8. УХОД ЗА АППАРАТОМ

Периодически протирайте электроды для дезинфекции спиртом или спиртосодержащей жидкостью. Предпочтительно, чтобы каждый пользующийся аппаратом имел свой комплект электродов. При длительном неиспользовании устройства необходимо раз в полгода заряжать аккумулятор аппарата.

ВНИМАНИЕ! Аппарат «ТГСп-3 (2 в 1)» не заменяет собой традиционные методы лечения заболеваний. Острые заболевания и хронические заболевания в период обострения требуют обращения к врачу.

Зарядка устройства.

Аппарат ТГСп-3 имеет функцию быстрой зарядки 18W, при использовании комплектного блока питания и провода USB-C, либо сторонних аксессуаров поддерживающих протокол зарядки QC 2.0, 18W.

Процесс зарядки аппарата «ТГСп-3 (2 в 1)».

При подключении зарядного устройства к аппарату «ТГСп-3 (2 в 1)» загорается синий индикатор в области индикатора заряда (2). Уровень заряда встроенного аккумулятора можно отслеживать по индикатору заряда (2).

Во избежании паразитных пульсаций из сети, не рекомендуется использовать аппарат при зарядке аккумулятора.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

● **Комплектность поставки:**

Аппарат ТГСп-3 (2 в 1) 1шт.;
Электроды контактные.....1 комп. (серый (**+**), чёрный (**-**);
Катушка «Диск» (опционально).....1шт.;
Катушка «Тор» (опционально).....1шт.;
Зарядное устройство 5В, 2А 1шт.;
Инструкция по эксплуатации .....1шт.

Гарантийный ремонт аппарата производится в течение 12 месяцев со дня приобретения аппарата.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АППАРАТА:

Вес..... Нетто 1050 г, Брутто 1450 г.;
Длинна.....192 мм.;
Ширина.....150 мм.;
Высота.....71 мм.;
Питание.....5В, 2А. (USB-C);
Диапазон частот.....30-999 кГц.;
Емкость аккумулятора.....5200 mAh (Li-Ion 18650).

Тольяттинский генератор сигнала портативный «ТГСп-3 (2 в 1)» изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТТУ 28.99.39-002-45309611-2021, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) и признан годным для эксплуатации.

Декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.42024/23

ООО «ТГС» г. Тольятти,
ул. Ярославская д. 8, оф. 205
e-mail: tgs63@bk.ru
Сайт: https://implovit.ru/

Бесплатный телефон:
8-(800)-550-01-51
Телефон офиса:
8-(937)-645–26–46

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Гарантия 1 год (12 месяцев) с даты продажи аппарата. Обязательное условие гарантии: заполнение даты продажи и указание продавца, а также наличие всех пломб (наклеек) и голограмм.

Дата изготовления_____
Продавец_____
Дата продажи_____ м.п.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию аппарата, не ухудшающие его технические и эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя.

«Цеппинг» - цикл проведения процедуры, при котором происходит избирательное поражение патогенов.